

Bearbeitung des DAHZ/BZÄK-Hygieneplans im Adobe Reader XI

Mit der neuen Version stehen zusätzliche Möglichkeiten für die Bearbeitung von Formularen zur Verfügung.

Streichung nicht eingesetzter Verfahren:

Kommentar – Grafikmarkierungen – Linie

Linie über den zu streichenden Bereich ziehen

The screenshot shows the Adobe Reader XI interface. The main content is a table titled "semikritisch A (maschinelle Verfahren)". A red diagonal line is drawn across the table. A blue arrow points from the "Grafikmarkierungen" (Graphic Markings) toolbar on the right to the red line. The toolbar includes options for text, images, and lines.

	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
ittell ve,	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">nach jeder Verwendung am Patienten	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten befasst sind
men	oder Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validiert wurde	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zeiinstofftücher entfernen)	
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator)*	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)	
	oder			

Mit Mausklick rechts können die Eigenschaften der Linie geändert werden:

The screenshot shows the "Linien-Werkzeug - Eigenschaften" (Line Tool - Properties) dialog box. It has two tabs: "Erscheinungsbild" (Appearance) and "Allgemein" (General). The "Allgemein" tab is active. The settings are:

- Anfang: Kein
- Ende: Kein
- Stil: —
- Stärke: 1 pt
- Farbe: [Red square]
- Füllfarbe: [Red square with diagonal line]
- Deckkraft: 100%

At the bottom, there is a "Gesperrt" (Locked) checkbox, and "OK" and "Abbrechen" (Cancel) buttons.


Zufügen von eigenem Text

Ausfüllen und Unterschreiben – Text hinzufügen

Mausklick auf dem Bereich, der beschriftet werden sollte

Text eingeben

ggf. Texteigenschaften anpassen

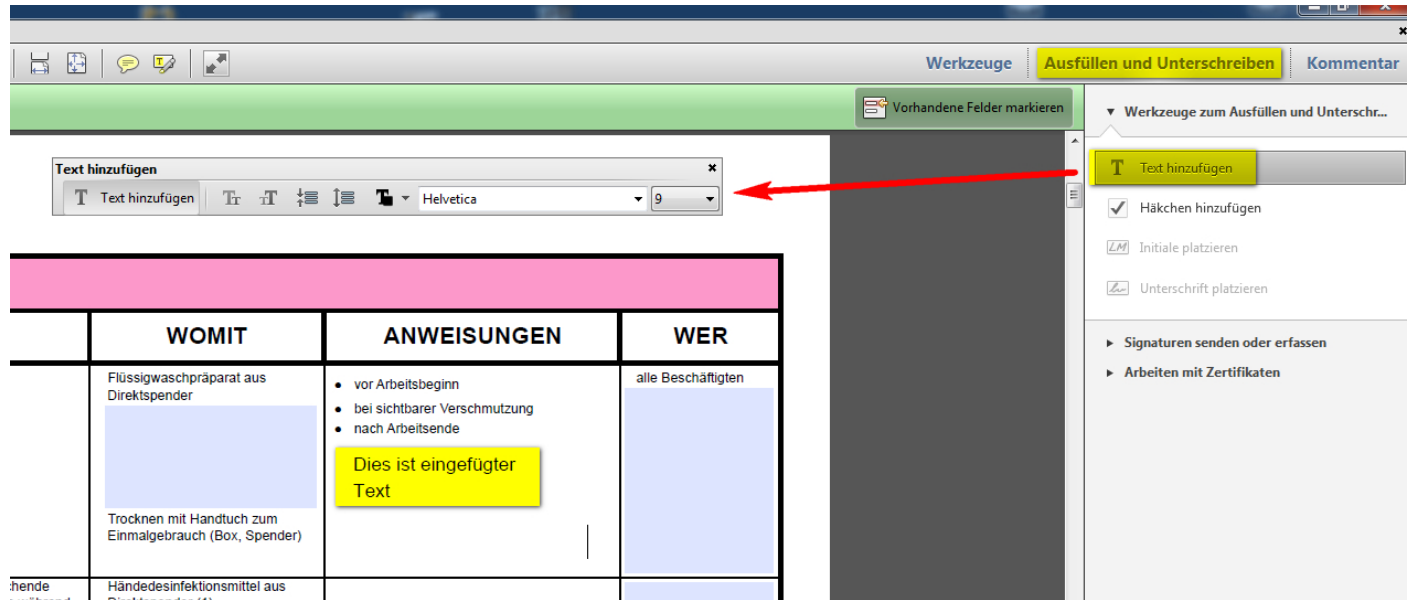

The screenshot shows a software interface with a table and a sidebar. The table has three columns: 'WOMIT', 'ANWEISUNGEN', and 'WER'. The 'ANWEISUNGEN' column contains a list of instructions and a yellow box with the text 'Dies ist eingefügter Text'. A red arrow points from the 'Text hinzufügen' button in the sidebar to the 'Text hinzufügen' tool in the top toolbar. The sidebar also contains options like 'Häkchen hinzufügen', 'Initiale platzieren', and 'Unterschrift platzieren'.

	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
	Flüssigwaschpräparat aus Direktspender Trocknen mit Handtuch zum Einmalgebrauch (Box, Spender)	<ul style="list-style-type: none">• vor Arbeitsbeginn• bei sichtbarer Verschmutzung• nach Arbeitsende <p>Dies ist eingefügter Text</p>	alle Beschäftigten
hende während	Händedesinfektionsmittel aus Direktspender (4)		

Abdecken nicht benötigter Bereiche:

Kommentar – Grafikmarkierungen – Rechteckwerkzeug

Über Rechtsklick Eigenschaften aufrufen:

„Farbe“ und „Füllfarbe“ auf Weiß / 100% Deckkraft setzen

Rechteck über abzudeckende Bereiche ziehen.

The screenshot shows a software interface with a toolbar on the right and a table on the left. The toolbar includes options for 'Anmerkungen', 'Grafikmarkierungen', and 'Kommentarliste (7)'. A yellow rectangle in the 'Grafikmarkierungen' section is highlighted with a blue arrow pointing to a cell in the table. The table is titled 'semikritisch A (maschinelle Verfahren)' and has columns 'WIE', 'WOMIT', 'ANWEISUNGEN', and 'WER'. The 'WOMIT' column contains several 'Gerät / Programm:' entries. The 'ANWEISUNGEN' column contains a list of instructions. The 'WER' column contains the text 'alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind'.

	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
el 3,	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">nach jeder Verwendung am Patienten	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind
en		Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstoffpapier entfernen)	
		Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)	
	oder Verfahren 3:	Gerät / Programm:		


The screenshot shows the 'Rechteck - Eigenschaften' dialog box. It has two tabs: 'Allgemein' and 'Überprüfungsverlauf'. The 'Allgemein' tab is active. It contains the following settings:

- Stil: [Dropdown menu]
- Stärke: 1 pt
- Farbe:
- Füllfarbe:
- Deckkraft: 100%

At the bottom, there are checkboxes for 'Gespert' and 'Eigenschaften als Standard festlegen', and buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.

Beispiele für die Bearbeitung des DAHZ/BZÄK-Hygieneplans mit dem Adobe Reader DC

Kommentarwerkzeug aus der Seitenleiste auswählen



z.B. Streichung nicht eingesetzter Verfahren mit dem Werkzeug „Linie zeichnen“

Start Werkzeuge Hygieneplan DAHZ... x

Linie zeichnen

Kommentar

Medizinprodukte semikritisch A (maschinelle Verfahren)				
WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	W
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen) ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen) 	alle Beschäftigt Aufbereitung v Medizinprodukt
	oder Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validebar ist	Gerät / Programm:		
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *	Gerät / Programm:		

z.B. Einfügen von zusätzlichem Text mit dem Werkzeug „Textkommentar hinzufügen“:

Kommentar ▾

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten
	oder Verfahren 1.2:	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen)
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator)*	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)

Zusätzlicher Text

z.B. Anhängen von Dokumenten (z.B. Arbeitsanweisungen) mit dem Werkzeug „Datei anhängen“

Kommentar ▾

Medizinprodukte semikritisch A (manuelle Verfahren)			
WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)	Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten
		Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)